Instructions de montage du dossier Pro-tech

Ce dispositif est conçu pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier des atouts importants d'un bon positionnement. Il doit être mis en place par des personnes qualifiées. Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible et si vous le jugez nécessaire à vous fournir une formation supplémentaire pour le montage de ce dossier.

Outils nécessaires: tournevis cruciforme, marteau, clé Allen de 1/8" (3 mm) et de 5/32" (4 mm).
Toutes les vis doivent être serrées à 20 in-lb (2,3 N). Lisez attentivement les instructions suivantes avant le montage.

Etape 1: Démontez la toile de dossier du fauteuil roulant.

Etape 2:
Perforez les trous, déjà partiellement percés, aux endroits appropriés à gauche et à droite de la coque (A) à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. (Figure 1)

Figure 1

Etape 3: Placez la coque

1) Pour réduire la profondeur d'assise de 0 à 3 cm (Figures 2 et 3)

Montez les supports en L (D) sur la coque (A) à l'aide des vis pour support (F), des rondelles (G) et des écrous (H). Fixez ensuite les crochets à l'aide des vis pour crochet (E) et des écrous (H) dans les deux trous les plus prés du crochet.

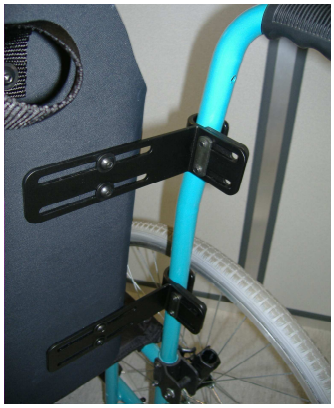

Figure 2

Figure 3

2) Pour augmenter la profondeur d'assise de 0 à 4,5 cm (Figures 4 et 5)

Montez les supports en L (D) sur la coque (A) à l'aide des vis pour support (F), des rondelles (G) et des écrous (H). Fixez ensuite les crochets à l'aide des vis pour crochet (E) et des écrous (H) dans les deux trous les plus éloignés du crochet.

Figure 4

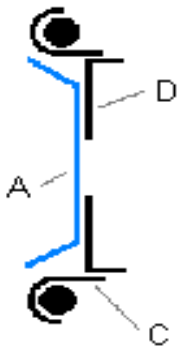

Figure 5

3) Pour augmenter la profondeur d'assise de 4,5 à 7 cm (Figures 6 et 7)

Montez les supports en L (D) sur la coque (A) à l'aide des vis pour support (F), des rondelles (G) et des écrous (H). Fixez ensuite les crochets à l'aide des vis pour crochet (E) et des écrous (H) dans les deux trous les plus prés du crochet.

Figure 6

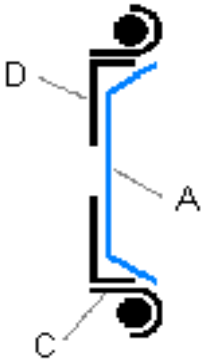

Figure 7

4) Pour augmenter la profondeur d'assise de 7 à 9,5 cm (Figures 8 et 9)

Montez les supports en L (D) sur la coque (A) à l'aide des vis pour support (F), des rondelles (G) et des écrous (H). Fixez ensuite les crochets à l'aide des vis pour crochet (E) et des écrous (H) dans les deux trous les plus éloignés du crochet.

Figure 8

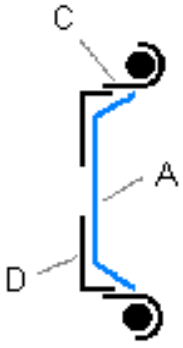

Figure 9

Etape 4:

Clipsez la coque (A) sur les cannes du fauteuil. Le bas de la coque doit arriver à hauteur de l'assise réhaussée du coussin d'assise (si par exemple le coussin d'assise est épais de 7 cm, alors le bas du dossier doit arriver à 7 cm de l'assise). Ajustez le positionnement du dossier. (Figure 10)

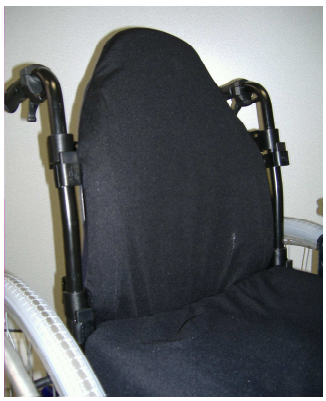

Figure 10

Etape 5:

Le VERSAlock (I) peut être utilisé comme matériel de fixation et/ou de guide de positionnement du dossier et peut être placé de plusieurs manières (Figures 11 et 12). Clipsez le VERSAlock (I) sur la canne du fauteuil. Fixez le à l'aide d'une vis, d'une rondelle et d'un écrou fournis (2 tailles sont proposées pour pouvoir s'adapter à tous les diamètres de canne). Le côté du VERSAlock (I) avec la vis doit se situer à l'arrière du fauteuil. Faites coulisser la langette en plastique de manière à ce qu'elle bloque la coque du dossier (A).

Figure 11

Figure 12

Etape 6:

Resserez les vis. Vous pouvez maintenant placer le coussin (B) sur la coque (A) et le coussin d'assise.

Limites d'utilisation	Maintenance	Formation	Entretien
Invacare ne connaît pas de fauteuil roulant avec lequel le dossier ne serait pas compatible. Toutefois, si vous avez un problème de compatibilité, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. Le dossier Pro-tech ne doit pas être utilisé pour le transport.	Le dossier Pro-tech doit être contrôlé tous les 3 mois par une personne qualifiée telle qu'un technicien de la réadaptation ou un ergothérapeute, afin de repérer tout signe de dommage pouvant affecter son efficacité.	Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire pour le montage du dossier Pro-tech ou de plus ample renseignements sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec Invacare.	La housse du coussin peut être nettoyée avec une solution de détergent neutre et de l'eau chaude appliquée à l'aide d'une lingette à usage unique ou peut être lavée à 60°. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des phénols ou de l'alcool. La housse doit être soignesement séchée par égouttement avant d'être remise sur le coussin. Ne la passez pas dans le sèche linge. Si la housse est contaminée, veuillez demander conseil à votre agent de prophylaxie des infections. Sinon veuillez prendre contact avec Invacare pour obtenir des informations sur le protocole de décontamination.